

# MANUEL D'UTILISATION

Foodcare

## HI981035 Testeur pH pour les sushis



 **HANNA**<sup>®</sup>  
instruments

[www.hannainstruments.fr](http://www.hannainstruments.fr)

# Remerciements

Merci d'avoir choisi un produit Hanna Instruments. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'instrument.

Pour plus d'informations, visitez notre site : [www.hannainstruments.fr](http://www.hannainstruments.fr) ou envoyez nous un mail à [info@hannainstruments.fr](mailto:info@hannainstruments.fr).

## Examen préliminaire

Déballiez l'instrument et examinez-le attentivement afin de vous assurer qu'aucun dommage n'a été causé pendant le transport. Si vous constatez une détérioration, contactez Hanna Instruments.

Chaque instrument est livré avec :

- Solution tampon pH 4,01 (2 pcs.)
- Solution tampon pH 7,01 (2 pcs.)
- Solution de nettoyage et de désinfection pour produit laitier (2 pcs.)
- Solution de conservation, goutteur 13 mL
- Manuel d'utilisation
- Certificat de qualité

*Note : Conservez l'emballage du matériel jusqu'à vous être assurés que l'instrument fonctionne correctement. Tout instrument endommagé ou défectueux doit être retourné dans son emballage d'origine avec les accessoires livrés.*

## Application prévue

Le riz à sushi doit être maintenu au chaud (environ 32 °C) pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous roulez les sushis. Cependant, cela peut créer des risques en matière de sécurité alimentaire et amener les services de santé à sévir contre les pratiques de manipulation du riz à sushi, qui est souvent conservé pendant plusieurs heures dans la "zone dangereuse" de température.

Dans la fabrication du sushi, la surveillance du pH est considérée comme essentielle et un certain nombre de nos clients sont tenus de tenir un registre des temps d'attente et du pH. La plupart des municipalités exigent que le riz à sushi soit maintenu à un pH inférieur à 4,6. Les procédures entourant cette norme peuvent varier du système d'analyse des dangers et des points critiques (HACCP) pour les sushis aux tests du ministère de la Santé. Heureusement, le pH peut être contrôlé avec du vinaigre de riz, un ingrédient traditionnel utilisé dans le riz à sushi.

## Caractéristiques de l'électrode

### Formulation de verre basse température

Le verre basse température (LT) assure une stabilisation rapide et des résultats plus précis à basse température. Ceci est bénéfique car de nombreux produits alimentaires sont stockés à basse température.

## Capteur en verre plat

Un capteur plat optimise la surface de contact pour la mesure sur les sushis plats et les échantillons qui ne peuvent pas être pénétrés.

## Jonction de référence ouverte

La technologie à jonction ouverte utilise une interface en gel solide entre l'échantillon et la cellule de référence interne. Cette interface empêche l'argent de sortir de la jonction, mais la rend également imperméable au colmatage, ce qui permet une réponse rapide et une lecture stable. Grâce à cette technologie, l'instrument peut être utilisé pour des échantillons de plus petite taille car il n'y a pas de jonction à immerger.


Verre sensible au pH

Jonction ouverte



## Spécifications

Gamme	pH 0,0 à 14,0
Résolution	0,1 pH
Précision	±0,2 pH
Étalonnage	Automatique, en un ou deux points
Électrode	Électrode intégrée pour application spécifique
Pile	CR2032 Li-ion
Durée de vie de la pile	Approximativement 1000 heures en continu
Auto-extinction	8 minutes, 60 minutes, ou désactivée
Environnement	0 à 50°C ; 95% HR max
Dimensions	51 x 160 x 21 mm
Poids	52 g

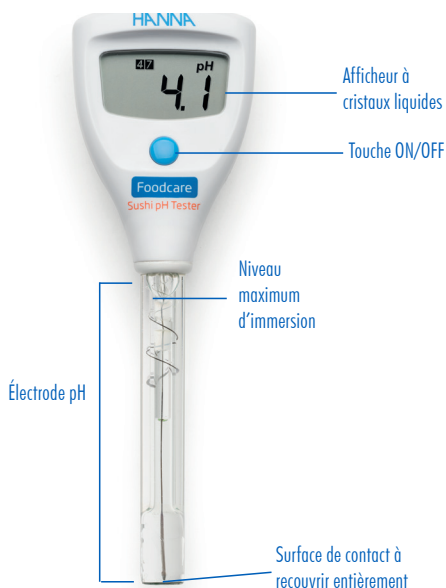

## Aperçu de l'instrument

### Préparation :

Vérifiez que l'électrode de pH a été maintenue hydratée en vérifiant que le capuchon contienne de la solution de conservation. Si l'électrode est sèche avant d'utiliser l'instrument, **retirez le capuchon de protection** et conditionnez l'électrode en trempant le bout de celle-ci (1 cm) dans la solution tampon pH 7 pendant plusieurs heures. Puis suivez la procédure d'étalonnage.

- Ne vous inquiétez pas si des cristaux blancs apparaissent autour du capuchon. Ceci est normal pour les électrodes pH, ils se dissoudront lors d'un rinçage à l'eau.
- Allumez l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
- Retirez le capuchon de protection et placez le bout plat de l'électrode, entièrement, sur l'échantillon à mesurer.

NE JAMAIS IMMERGER L'ÉLECTRODE AU-DESSUS DU NIVEAU MAXIMUM D'IMMERSION.


- Pour des résultats précis, étalonnez fréquemment.
- Après utilisation, rincez l'électrode à l'eau et la stocker en mettant quelques gouttes de solution de conservation dans le capuchon.
- Remettez le capuchon après chaque utilisation.

NE PAS UTILISER D'EAU DÉMINÉRALISÉE OU DÉIONISÉE POUR LE STOCKAGE DE L'INSTRUMENT.

### Mode opératoire


Appuyez sur ON/OFF pour allumer l'instrument. Tous les segments seront allumés.

L'instrument ira en mode mesure : la mesure actuelle ainsi que les points étalonnés seront affichés.



### Étalonnage de l'instrument

À partir du mode mesure, appuyez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF jusqu'à l'affichage de "CAL".



Lorsque "7.01" clignote, placez le bout de l'électrode dans une solution tampon pH 7,01 ou 4,01.

**A**

Pour un étalonnage en un point ou deux points utilisant la solution tampon pH 7,01 suivez la procédure A

**B**

Pour un étalonnage en un point utilisant la solution tampon pH 4,01 suivez la procédure B

**A****Étalonnage en un ou deux points avec pH 7,01.**

Si la solution tampon pH 7,01 est utilisée pour le premier point le tampon est reconnu avec le sablier clignotant.

Lorsque la mesure est stable, le sablier disparaît et le point pH 7 est étalonné. Si pH 7 est le seul point d'étalonnage, terminez la procédure de droite.

Si pH 4,01 est utilisé en second point, suivez la procédure deux points à droite.

**Un point**

pH 4,01 clignotera alors sur l'afficheur. Ignorez cela est appuyez sur la touche ON/OFF.



"Sto" sera affiché lorsque l'étalonnage sera validé.



L'instrument revient en mode mesure et le symbole du point étalonné sera affiché.

**Deux points**

Utilisez pH 4,01 pour réaliser un étalonnage en deux points. La valeur est automatiquement reconnue avec le sablier clignotant.



Lorsque la mesure est stable, le sablier disparaît. "Sto" sera affiché lorsque l'étalonnage sera validé.



L'instrument revient en mode mesure et les symboles des points étalonnés seront affichés.

**B****Étalonnage en un point avec pH 4,01.**

Si la solution tampon pH 4,01 est utilisé comme premier point la valeur du tampon est reconnue et affichée avec le sablier clignotant.



Lorsque la mesure est stable, le sablier disparaît. "Sto" sera affiché lorsque l'étalonnage sera validé.



L'instrument revient en mode mesure et le symbole du point étalonné sera affiché.

## Auto-extinction

À partir du mode mesure, appuyez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF. L'instrument fait une boucle entre "OFF", "CAL" et le réglage courant de l'auto-extinction.

Le réglage par défaut est 8 minutes ("d08"). Appuyez sur la touche ON/OFF pour le modifier. "d60" pour 60 minutes et "d--" pour désactiver la fonction. Appuyez et maintenez la touche pour sortir du menu.



## Effacer l'étalonnage

Mettez l'instrument en mode étalonnage. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ON/OFF jusqu'à ce que "CLR" s'affiche. L'instrument est à présent sur l'étalonnage usine.



## Message "Err"

En mode étalonnage, si l'instrument affiche un message "Err" lorsque l'électrode est dans une solution étalon fraîche, alors l'électrode doit être nettoyée. Placez l'électrode dans la solution de nettoyage [HI700641](#) pendant 20 minutes. Rincez à l'eau pure et mettez à tremper dans [HI 70300](#) pendant une heure avant d'étalonner.



## Indicateur de pile


L'instrument a une fonction d'avertissement de pile faible. Lorsque la pile est faible, le symbole de la pile clignote sur l'écran. Lorsque la pile est vide, "Erb" apparaît sur l'écran et l'instrument s'éteint.



## Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile Li-ion CR2032, tournez le courvecle du compartiment à pile, à l'arrière de l'instrument, dans le sens anti-horaire pour le débloquer. Retirez le couvercle et remplacez la pile, polarité + vers le dessus.

*Note: Le remplacement de la pile doit se faire dans une zone sûre et en utilisant le type de pile spécifié dans ce manuel. L'ancienne pile doit être recyclée selon les lois en vigueur.*

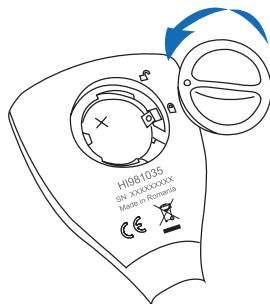

## Accessoires

### Solution tampon pH

Code	Description
<b>HI70004P</b>	Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL
<b>HI70007P</b>	Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL
<b>HI77400P</b>	Solution tampon pH 4,01 & 7,01, sachets de 20 mL (10 pièces, 5 de chaque)

### Solution de nettoyage pour électrode

Code	Description
<b>HI700601P</b>	Solution de nettoyage usage général, 25 sachets de 20 mL
<b>HI700641P</b>	Solution de nettoyage et de désinfection pour produit laitier, 25 sachets de 20 mL

### Solution de conservation

Code	Description
<b>HI70300L</b>	Solution de conservation, bouteille de 500 mL
<b>HI70300M</b>	Solution de conservation, bouteille de 230 mL
<b>HI9072</b>	Solution de conservation, goutteur de 13 mL

## Entretien et maintenance

Pour obtenir la plus grande précision lors des mesures il est important de suivre les conseils ci-dessous :

- L'étalonnage est aussi bon que les solutions utilisées. La valeur du pH évolue dans le temps une fois que le sachet est ouvert. Des solutions tampons fraîches doivent être utilisées à chaque étalonnage.
- L'électrode doit être rincée à l'eau pure avant d'être plongée dans une solution tampon ou l'échantillon à mesurer.
- Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, il est important de mettre quelques gouttes de solution de conservation dans le capuchon pour conserver l'électrode humide. À défaut de solution de conservation, de la solution tampon pH 4 ou pH 7 peut-être utilisée.

- Pour améliorer la précision, il est recommandé de faire un étalonnage en deux points.
- Il est important d'étalonner l'instrument et de faire des mesures à la même température. Un écart conséquent entre la température d'étalonnage et la température de mesure des échantillons entraînera une imprécision des mesures.
- En cas d'encrassement, nettoyez l'électrode en la trempant dans une solution de nettoyage pendant 20 minutes, puis rincez le bout et trempez dans une solution de conservation au moins 30 minutes avant utilisation. Réétalonnez après chaque nettoyage.

## Garantie

L'instrument est garanti pour une période d'un an contre les défauts de fabrication et de matériaux lorsqu'il est utilisé à bon escient et entretenu conformément aux instructions. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement sans frais. Les dommages dus à des accidents, une mauvaise utilisation ou un défaut d'entretien ne sont pas couverts. Si une réparation est nécessaire, retournez votre instrument à Hanna Instruments France. Si l'instrument est sous garantie, précisez la référence, la date d'achat (joindre une copie de la facture), le numéro de série et la nature du problème rencontré. Si la réparation n'est pas couverte par la garantie, un devis vous sera envoyé pour acceptation. Lors de l'expédition de tout instrument, assurez-vous qu'il est correctement emballé afin d'éviter un endommagement du matériel lors du transport.

## Recommandations

Avant d'utiliser cet instrument assurez-vous qu'il convient parfaitement à votre application ainsi qu'à l'environnement dans lequel il sera utilisé. Toute modification introduite à l'instrument, par l'utilisateur, peut dégrader les performances EMC de celui-ci. Pour votre sécurité ainsi que celle de l'instrument, n'utilisez ou ne stockez l'instrument dans des environnements dangereux.

## Certification

Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives européennes CE.



**Élimination des équipements électriques et électroniques.** Le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Remettez-le dans un point de collecte approprié au recyclage des équipements électriques et électroniques, ce qui permettra de préserver les ressources naturelles.



**Élimination des piles usagées.** Ce produit contient des piles, ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Remettez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.



S'assurer d'une élimination appropriée des produits et des piles prévient les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations, contactez votre ville, votre service local d'élimination des déchets ménagers, le lieu d'achat ou rendez-vous sur [www.hannainstruments.fr](http://www.hannainstruments.fr).